


Lidal - GIE
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 02/02/2023

MAIRIE DE LA VERNAZ
CHEF LIEU
74200 LA VERNAZ

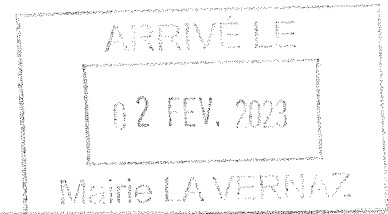

RAPPORT D'ANALYSE Eaux production E23.434.2_20230202154530

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 2 pages. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	30/01/2023 09:09	Nom Installation * :	STATION UF JOTTY ✓
Date de réception :	30/01/2023 14:15	Code et Nom PSV * :	0000007053 - STATION UF JOTTY AVANT TRT
Date début analyse :	30/01/2023	Commune* :	VERNAZ (LA)
Prélevé par :	HERAN Yoan - HER	Localisation exacte :	Trop plein cuve de stockage avant traitement
X Normes :	FD T90-520 et NF EN ISO 19458	Type d'eau * :	B - EAU BRUTE SOUTERRAINE
Motif * :	CONTROLE COMPLEMENTAIRE	Type d'analyse * :	D1P
Type visite * :	AU - AUTRE TYPE DE VISITE	Type traitement * :	
Code et nom UGE* :	0195 - LA VERNAZ	Type d'installation * :	TTP

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
----------------------	-----------	-------	-------------------	-----------------------	----------

BACTÉRIOLOGIQUE

X Bactéries coliformes	16	UFC/100ml		NF EN ISO 9308-1:2000	
X Entérocoques	<1	UFC/100ml		NF EN ISO 7899-2	
X Escherichia coli	<1	UFC/100ml		NF EN ISO 9308-1:2000	
X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	61	UFC/ml		NF EN ISO 6222	
X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	1	UFC/ml		NF EN ISO 6222	

ORGANOLEPTIQUE

X Couleur	<5	mg(Pt) /L		NF EN ISO 7887 (Mét. D)	
Saveur	Normal			QUALITATIF	

PHYSICO-CHIMIQUE

X pH	8.1	unité pH		NF EN ISO 10523	
Température de mesure du pH	22.8	°C		NF EN ISO 10523	
X Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	275	µS/cm		NF EN 27888	
X Turbidité	0.41	NFU		NF EN ISO 7027-1 : 2016	
X Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L		NF T 90-015-2	


TERRAIN

Pluviométrie à 48H	Pas de précipitations			Observation	
Température Eau	5,7	°C		Méthode à la sonde	
Aspect	Normal			Qualitatif	
Odeur	Normal			Qualitatif	

Lidal - GIE
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 02/02/2023

MAIRIE DE LA VERNAZ
CHEF LIEU
74200 LA VERNAZ



VIDALE DUSONCHET Muriel

Resp. unité Hygiène Alimentaire

BURNAT Lydie

Resp. unité Chimie des eaux

CANCOUET Julie

Resp. unité logistique